



LOMO Kreuztisch

Quadratisch, Bedienung unten

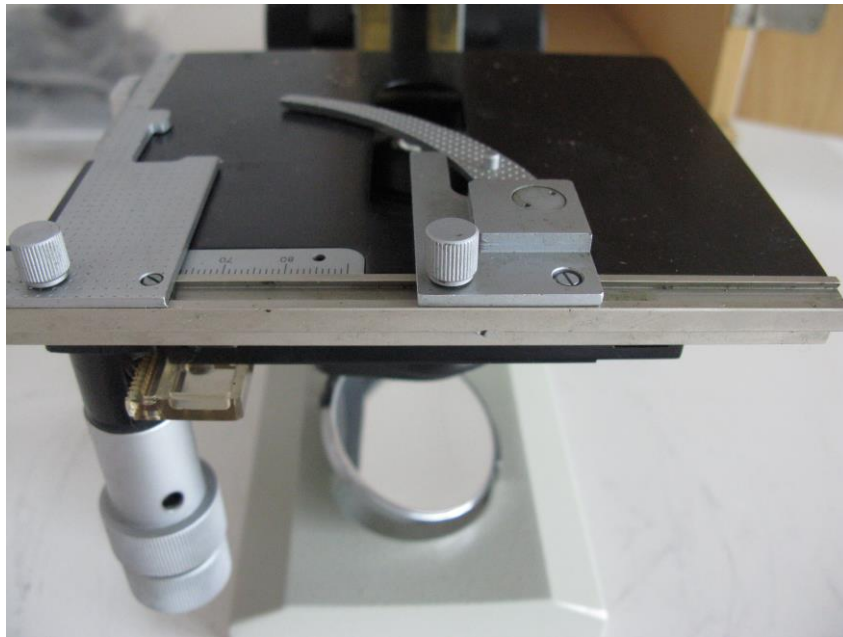

Kreuztisch für die Biolam Mikroskope, sowie für die Mikroskope mit Schnellhalter ([Lumam](#), [ML](#), [ML-A](#), [Biolam-M](#), [Biolam-I](#), etc.)

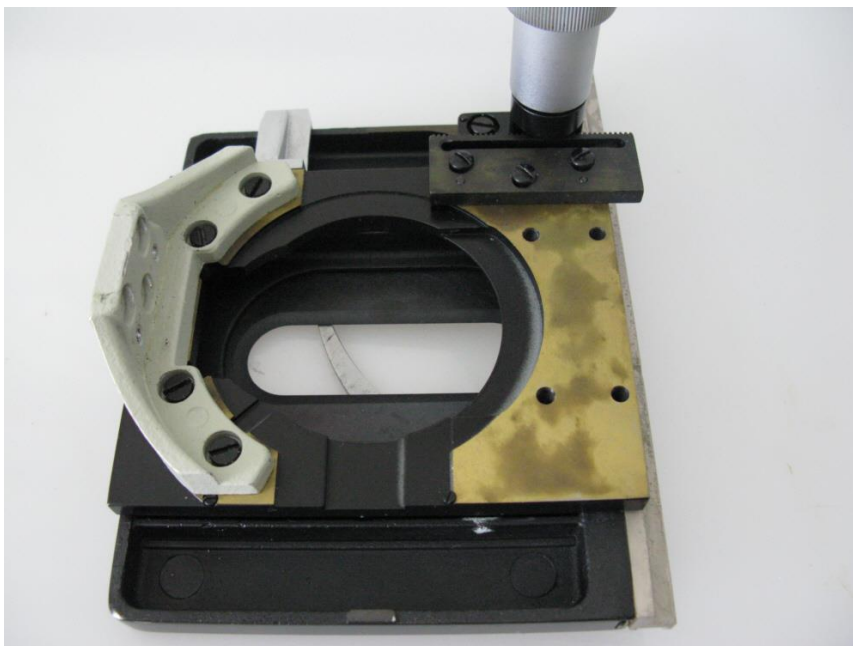

Die Unterseite weist Gewindelöcher für die Befestigung am Standardträger (links) oder am Schnellspanträger (rechts) auf.

Die Spannweite des Objektträgerhalters ist einstellbar.