



LOMO Biolam MBI
universal Mikroskoptisch
mit Schwalbe 33/30 für Lomo.

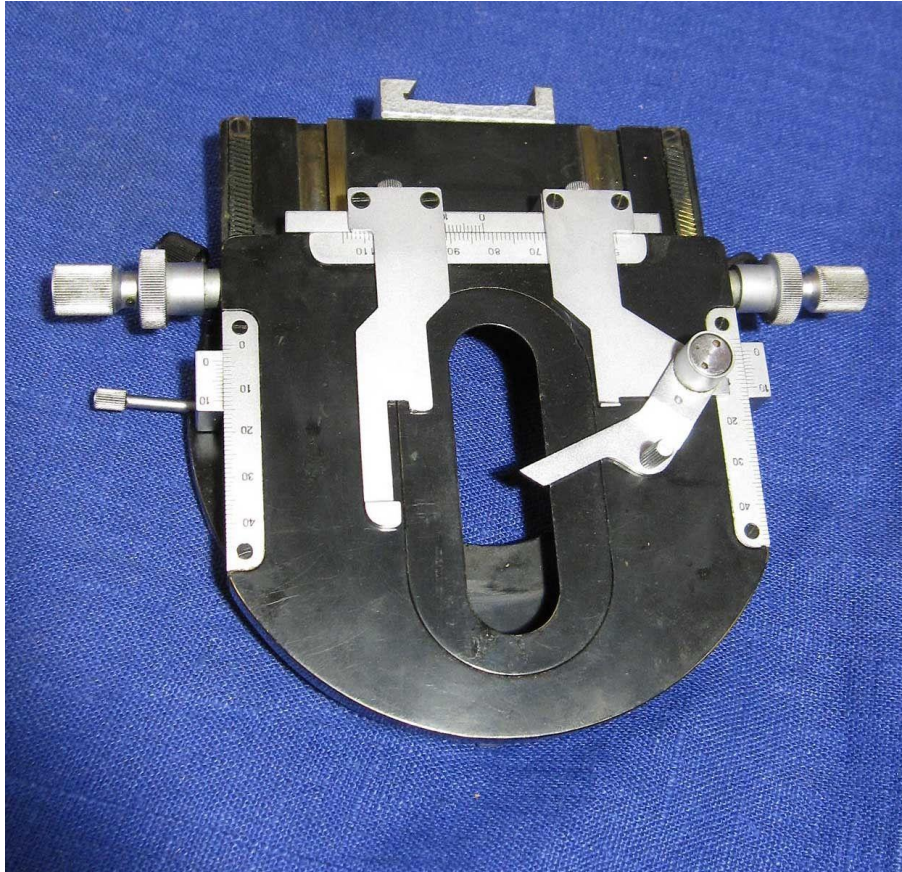


Draufsicht

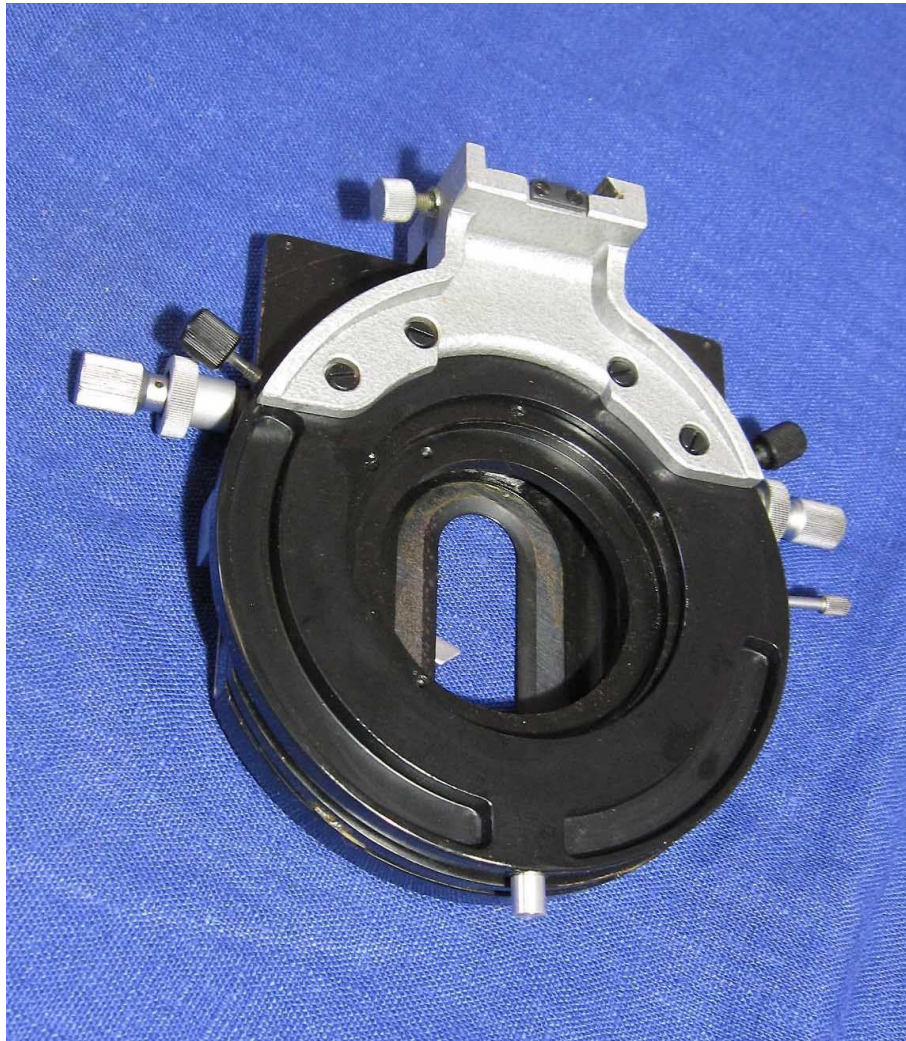


Ansicht von unten

**Die schwarzen Schrauben dienen zur Zentrierung des Tisches
Unten ist der Halter für den gefederten Gegenstift zu sehen.**

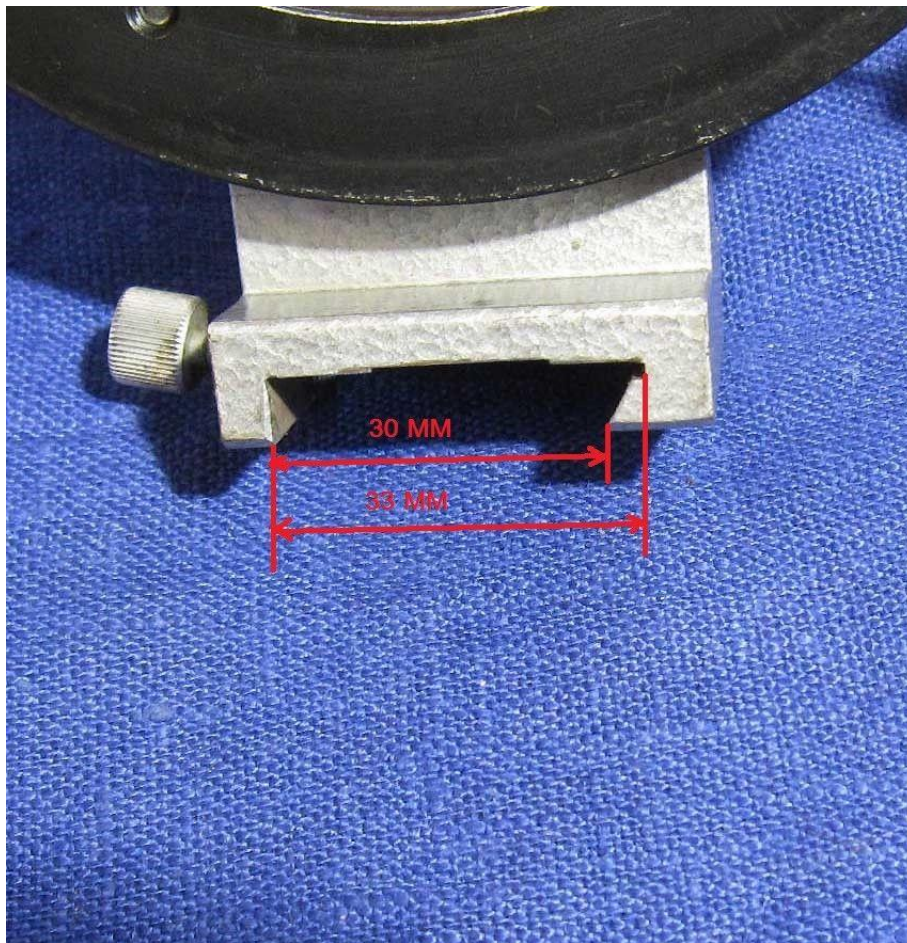

Maße der Befestigungsschwalbe

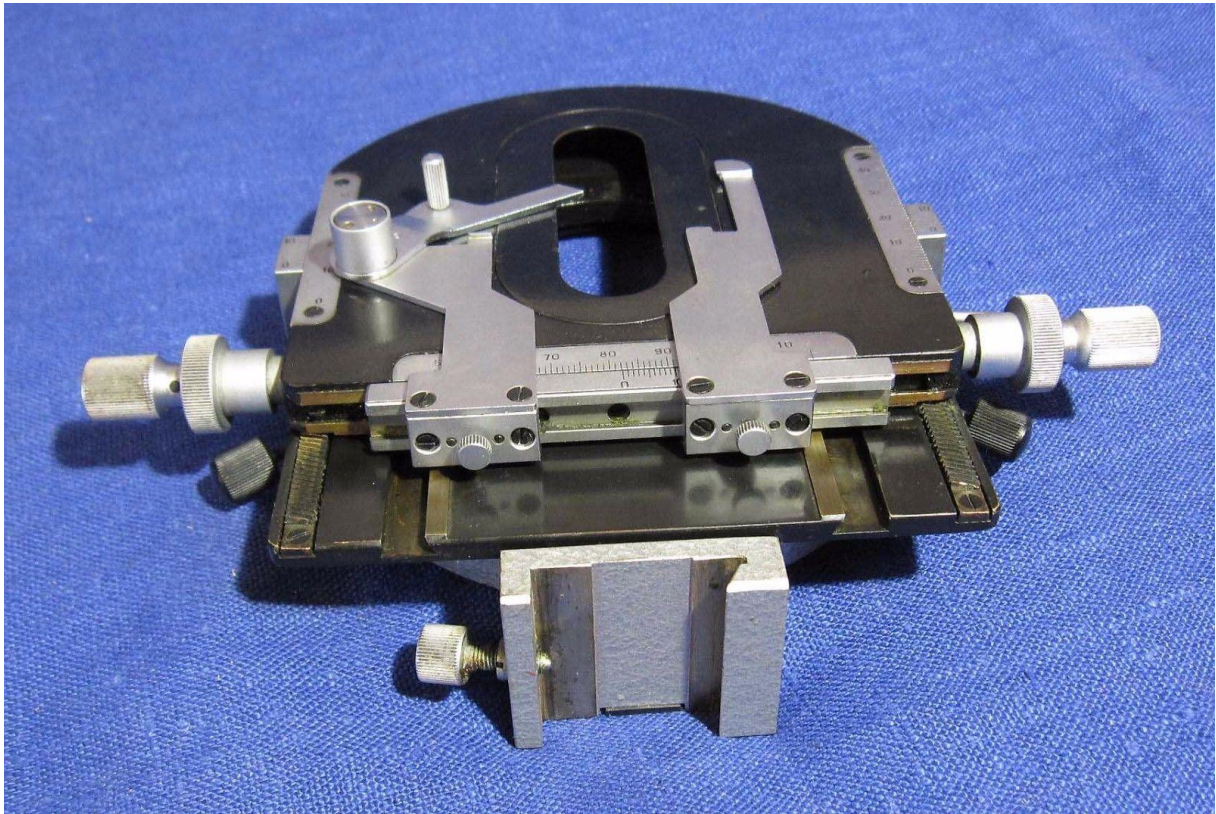

Ansicht von hinten

Die Tischbewegung erfolgt seitlich über koaxiale Triebe.

Der Tisch ist zu jeder Seite je nach Mikroskopausführung bis fast 90° drehbar.